



Pruebas de competencia de laboratorio en la UE

Tasa de error en los test de los laboratorios participantes

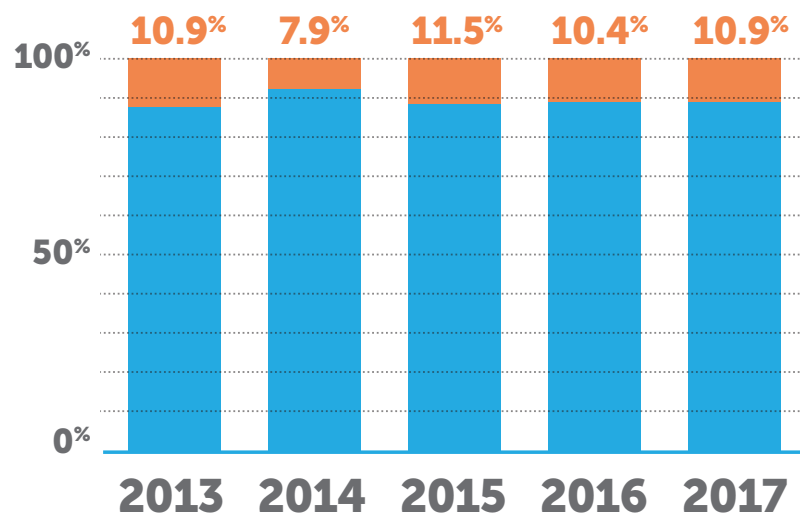

Leyenda: ■ Correcto ■ Incorrecto

Tasa de error por parámetro (más frecuente)

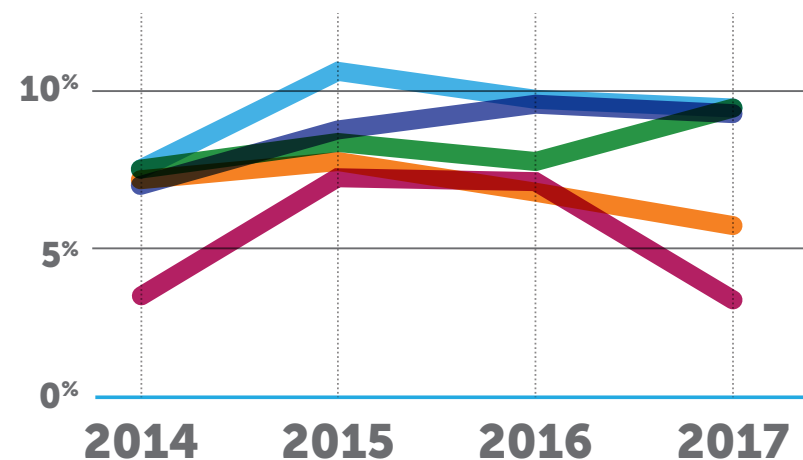

Leyenda: ■ Nitrógeno total ■ Fósforo total
■ Nitrato ■ Amoníaco ■ DQO

Fuente, Universidad de Stuttgart, <http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/>



Be Right™